

Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets

(11) **EP 1 018 322 A1**

(12) **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(43) Date de publication:  
12.07.2000 Bulletin 2000/28

(51) Int. **A61F 2/38**  
Cl.7:

(21) Numéro de dépôt: **99403314.0**

(22) Date de dépôt: **29.12.1999**

(84) Etats contractants désignés:  
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT**  
**LI LU MC NL PT SE**  
Etats d'extension désignés:  
**AL LT LV MK RO SI**

(30) Priorité: **04.01.1999 FR 9900012**

(71) Demandeurs:  
, **Aesculap**  
**52901 Chaumont Cedex 9 (FR)**  
, **Reigner, Bernard, Dr.**  
**72000 Le Mans (FR)**

(72) Inventeurs:  
, **Reigner, Bernard, Dr.**  
**72000 Le Mans (FR)**  
, **Blegun, Jean-François**  
**52000 Chuamont (FR)**  
, **Marceaux, Pascal**  
**52000 Chaumont (FR)**

(74) Mandataire:  
**Eidelsberg, Victor Albert**  
**20, rue Vignon**  
**75009 Paris (FR)**

(54) **Prothèse tibiale du genou à double insert**

(57) Endoprothèse du genou, comportant une partie tibiale, constituée d'une tige tibiale portant une plaque tibiale, un premier insert (11) tibial disposé sur la plaque tibiale, une partie fémorale, constituée d'une tige fémorale, qui porte deux condyles (8, 9) ayant chacun une première surface de glissement coopérant, de manière congruente, avec une deuxième surface de glissement respective formée sur le premier insert (11) tibial, un organe de couplage destiné à coupler la partie tibiale à la partie fémorale pour permettre une flexion du fémur par rapport au tibia d'une position ( $\alpha$  sensiblement = 0) où le genou est étendu à une position ( $\alpha_{\max}$ ) où le genou est plié et inversement. Il est prévu un élément de blocage progressif destiné à limiter le déplacement en rotation latérale et en rotation propre des condyles (8, 9) par rapport à la plaque tibiale à partir d'un angle  $\alpha$

$\alpha_0$  de flexion du genou déterminé à l'avance jusqu'à un angle nul, l'amplitude de déplacement en rotation propre allant en diminuant de cet angle  $\alpha_0$  jusqu'à une amplitude nulle (blocage total) pour l'angle nul (genou déplié).

EP 1 018 322 A1

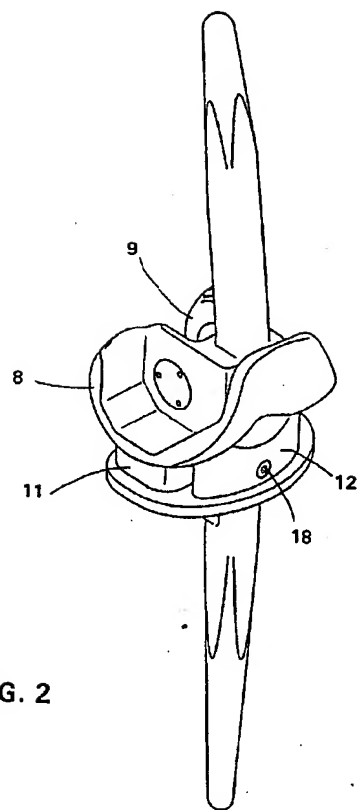


FIG. 2

## Description

La présente invention concerne une endoprothèse du genou, du genre comportant une partie  
 5 tibiale constituée d'une tige tibiale, destinée à être insérée par une extrémité dans le tibia  
 du patient, et d'une plaque tibiale fixée à l'autre extrémité de la tige tibiale ; un insert  
 tibial disposé sur la plaque tibiale ; et une partie fémorale constituée d'une tige fémorale et  
 10 de condyles portés par la tige fémorale comportant chacun une première surface de glissement  
 de forme correspondante à une seconde surface de glissement de l'insert tibial, les condyles  
 étant séparés au moins partiellement par un intervalle intercondylien ;

les condyles et l'insert tibial coopérant par l'intermédiaire d'un organe de couplage,  
 constitués par exemple d'un tourillon qui passe à travers l'insert tibial par une ouverture  
 15 formée dans l'insert et qui est fixé à la partie tibiale ; d'une tête de couplage, tête de  
 couplage qui pénètre dans l'intervalle intercondylien et d'un axe de couplage, fixé aux condyles  
 et pénétrant dans une ouverture de la tête de couplage, la partie fémorale pouvant ainsi pivoter  
 par rapport à cet axe de couplage de manière à pouvoir passer d'une position déployée  
 20 (extension totale du genou) à une position pliée (flexion à environ 120° du genou).

Une prothèse du genou de ce genre est connue par exemple du document EP-0.791.343.

Les prothèses du genou de ce genre présentent plusieurs inconvénients.

L'insert tibial, en général en polyéthylène, est monté libre en rotation par rapport à la  
 25 plaque tibiale (généralement métallique) de manière à permettre un jeu en rotation propre du  
 fémur par rapport au tibia, cette rotation propre s'effectuant par l'intermédiaire des condyles  
 (en général métallique) glissant sur les surfaces de glissement correspondantes de l'insert  
 30 tibial. En position déployée (angle  $\alpha$  de flexion du genou = 0°) du genou, la rotation du fémur  
 par rapport au tibia est bloquée par l'intermédiaire d'une liaison en butée des condyles sur  
 l'insert en polyéthylène. Cependant, dès que le genou vient à être plié ( $\alpha$  devient supérieur à 0°)  
 , ce blocage est totalement relâché et le fémur peut donc subir des déplacements en rotation  
 35 axiale très grands alors que le genou est à peine plié. Cela ne reproduit pas la réalité du  
 genou anatomique et peut entraîner des coincements que l'on ne souhaite pas.

L'invention vise à pallier ces inconvénients en proposant une prothèse dans laquelle le  
 verrouillage de la partie fémorale à la partie tibiale, lors du déplacement du genou jusqu'à une  
 40 position totalement déployée du genou, s'effectue progressivement au cours de l'extension  
 (déploiement) du genou.

Cela est obtenu en prévoyant un élément de blocage progressif destiné à limiter le  
 déplacement en rotation propre des condyles par rapport à la plaque tibiale à partir d'un  
 45 angle  $\alpha_0$  de flexion du genou déterminé à l'avance jusqu'à un angle nul, l'amplitude de  
 déplacement en rotation propre allant en diminuant de cet angle  $\alpha_0$  jusqu'à une amplitude nulle  
 (blocage total) pour l'angle nul (genou déplié).

Suivant un perfectionnement avantageux de l'invention, cet élément de blocage progressif est  
 50 constitué d'un second insert tibial monté fixe sur la plaque tibiale et dont la forme est telle  
 que, en position étendue du genou, le second insert tibial fixe vient faire saillie dans un  
 intervalle intercondylien formé entre les condyles et s'insère dans le siège formé par  
 l'intervalle intercondylien de manière à bloquer toute rotation mutuelle latérale ou axiale du  
 55 fémur par rapport au tibia et telle que lors de la sortie du second insert de son siège lors de  
 la flexion du genou, il s'instaure entre les parois de l'intervalle intercondylien et le second  
 insert un jeu progressif jusqu'à un angle de flexion ( $\alpha_0$ ) déterminé à l'avance, à partir duquel

## EP 1 018 322 A1

les déplacements en rotation axiale sont libres.

Suivant cet agencement particulier, on évite que l'insert tibial rotatif serve au blocage progressif des condyles et donc s'use aussi rapidement que dans le cas où l'élément de blocage fait partie intégrante de l'insert tibial, auquel cas l'insert tibial, qui est libre en rotation par rapport à la plaque tibiale subit des contraintes aussi bien due à la flexion qu'aux rotations axiales ou en varus/valgus. Maintenant, l'insert mobile ne subit plus de contrainte qu'en flexion, les contraintes en rotation axiale ou en varus/valgus, notamment en position bloquée, étant subies entièrement par le second insert tibial fixe.

Suivant un perfectionnement de l'invention, on prévoit de rendre fixe l'organe de couplage par rapport à la plaque tibiale pour limiter encore plus les possibilités de rotation propre, et ainsi encore mieux bloquer en position déployée le fémur par rapport au tibia.

La figure 1 est une vue en coupe latérale d'une prothèse de genou suivant l'invention, en position déployée.

La figure 2 est une vue en perspective de la prothèse de la figure 1, également en position déployée.

La figure 3 est une vue en perspective de la prothèse de la figure 2, en position pliée.

Les figures 4a, 4b et 4c sont des vues, respectivement, de côté, de côté avant et en coupe A-A de l'insert fixe.

A la figure 1, il est représenté une prothèse 1 du genou, constituée d'une partie 2 tibiale, d'une partie 3 de couplage et d'une partie 4 fémorale.

La partie 2 tibiale comprend une tige 5 tibiale destinée à être insérée et fixée dans le canal médullaire du tibia et une plaque 6 tibiale portée par la tige 5 tibiale.

La partie 4 fémorale comprend une tige 7 fémorale destinée à être insérée et fixée dans le fémur du patient et deux condyles 8, 9 de forme concave, les deux condyles 8, 9 étant séparés par un intervalle.

La partie 3 de couplage est constituée d'une part d'un premier insert 11 tibial, d'un deuxième insert 12 tibial et d'un organe 13 de couplage.

Le premier insert 11 tibial, qui est par exemple en polyéthylène est disposé sur la plaque 6 tibiale de manière à être libre en rotation par rapport à un premier axe de rotation 14, sensiblement parallèle à l'axe longitudinal de la tige 5 tibiale et légèrement décalé vers le côté antérieur du genou, par rapport à la tige 5 tibiale. Le premier insert 11 tibial, ou insert rotatif, comporte sur sa partie supérieure deux cavités dont les surfaces extérieures correspondent, de manière congruente, aux surfaces extérieures des condyles 8, 9.

Le deuxième insert 12 tibial, également par exemple en polyéthylène, est monté fixe sur la plaque 6 tibiale, une saillie mâle 17 de la plaque tibiale étant introduite dans une cavité femelle formée dans la partie inférieure de l'insert 12 fixe, de manière à fixer l'insert 12 fixe vis-à-vis de la plaque 6 tibiale. En outre une vis 18 fixe par vissage l'insert à la saillie mâle 17.

L'insert 12 fixe est mieux représenté aux figures 4a, 4b et 4c. Il comporte sur sa partie supérieure une crête 19 séparant la face supérieure en deux surfaces 20, 21 supérieures, qui sont chacune inclinées vers le bas en sens opposé. La crête 19 comporte trois tronçons 22, 23, 24 sensiblement en forme d'arcs de cercle dont les convexités sont alternées, le tronçon de milieu 23 ayant sa convexité tournée vers le haut, tandis que les deux autres tronçons 22, 24 latéraux de la crête ont leurs convexités tournées vers le bas (de la figure). La surface supérieure 21 tournée vers l'insert 11 mobile a une forme incurvée symétrique, par rapport au

## EP 1 018 322 A1

plan des deux tiges 5 et 7 tibiale et fémorale à la figure 3, de manière à former deux surfaces de glissement pour les surfaces de glissement des condyles.

5 L'organe 13 de couplage est constitué d'un tourillon 27 qui est monté, soit fixe en rotation, en ayant par exemple une section transversale du type 6-pans (non représentée aux figures) qui coopère avec les parois latérales de section transversale correspondante d'un évidement dans la tige 6 tibiale, soit rotatif dans un évidement de cette même tige 6 tibiale ayant par exemple une paroi latérale cylindrique circulaire. Le tourillon 19 traverse l'insert rotatif par une  
10 ouverture centrale de l'insert 11 rotatif, de sorte que le tourillon 27 forme l'axe de rotation de l'insert 11 rotatif.

L'organe 13 de couplage comprend également une tête 25 de couplage qui pénètre dans l'intervalle intercondyloire. Cette tête 25 de couplage comprend un évidement 26 dans lequel  
15 pénètre un axe 28 de couplage, fixé de part et d'autre de l'intervalle intercondylien aux condyles 8, 9; l'axe de couplage transversalement perpendiculaire à l'axe de rotation de l'insert 11 rotatif et éventuellement du tourillon 19 est perpendiculaire à l'axe antéro-postérieur.

La surface extérieure de l'axe 28 de couplage a, dans la partie se trouvant dans la tête de couplage, une forme sphérique et coopère avec une forme sphérique de l'évidement de la tête  
20 de couplage.

La partie 4 fémorale pivote, en flexion, par rapport à la partie 2 tibiale, suivant l'axe 28 de couplage, pour passer d'une position où le genou est étendu (fémur et tibia sensiblement  
25 parallèles,  $\alpha = 0$ ) à une position où le genou est fléchi au maximum (fémur et tibia formant un angle  $\alpha \approx 120^\circ$ ).

En position étendue, les surfaces extérieures des condyles 8,9 viennent en butée sur la crête 19 de l'insert fixe qui l'immobilise, d'une part en rotation de flexion, en empêchant la  
30 poursuite de la flexion et d'autre part également en rotation axiale, la surface extérieure concaves des deux condyles 8, 9 du côté avant du genou recevant entre elles la partie en forme de crête de l'insert 12 fixe et venant buter contre elles dans leur mouvement en rotation axiale.

Au fur et à mesure que le genou se plie, les surfaces extérieures des condyles 8, 9 du côté  
35 avant du genou, quittent leur coopération avec la crête 19 et la surface 21 extérieure, de sorte qu'un jeu progressif apparaît entre chaque condyle et sa partie de surface respective de la surface 21 extérieure. Ainsi le fémur peut progressivement avoir de nouveau un mouvement en rotation axiale. La forme des condyles et celle de la crête de l'insert fixe sont telles que la  
40 rotation axiale du fémur n'est libérée entièrement qu'au-delà d'un certain angle de flexion, par exemple ici  $30^\circ$ . Avant d'atteindre cet angle de flexion, la rotation axiale est limitée dans un domaine déterminée par les formes respectives de la crête et de la surface 21 extérieure, par exemple ici  $\pm 10^\circ$  pour  $\alpha_0 = 30^\circ$ .

45 On définit l'angle  $\alpha$  comme étant l'angle formé entre l'axe longitudinal du fémur et celui du tibia,  $\alpha$  pouvant varier de 0 (fémur et tibia parallèles, genou étendu) à  $120^\circ$  (angle maximal de flexion du genou).

50

### Revendications

1. Endoprothèse (1) du genou, comportant :

- 55
- une partie (2) tibiale, constituée d'une tige (5) tibiale portant une plaque (6) tibiale,
  - un premier insert (11) tibial disposé sur la plaque (6) tibiale,

## EP 1 018 322 A1

- 5       - une partie (4) fémorale, constituée d'une tige (7) fémorale, qui porte deux condyles (8, 9) ayant chacun une première surface de glissement coopérant, de manière congruente, avec une deuxième surface de glissement respective formée sur le premier insert (11) tibial,
- 10       - un organe (3) de couplage destiné à coupler la partie (2) tibiale à la partie (4) fémorale pour permettre une flexion du fémur par rapport au tibia d'une position ( $\alpha$  sensiblement = 0) où le genou est étendu à une position ( $\alpha_{\max}$ ) où le genou est plié et inversement, et
- 15       - un élément de blocage progressif destiné à limiter le déplacement en rotation latérale et en rotation propre des condyles (8, 9) par rapport à la plaque tibiale à partir d'un angle  $\alpha_0$  de flexion du genou déterminé à l'avance jusqu'à un angle nul, l'amplitude de déplacement en rotation propre allant en diminuant de cet angle  $\alpha_0$  jusqu'à une
- 20       amplitude nulle (blocage total) pour l'angle nul (genou déplié) ;

25       caractérisée en ce que l'élément de blocage progressif est constitué d'un second insert (12) tibial monté fixe sur la plaque tibiale et dont la forme est telle que, en position étendue du genou, le second insert tibial fixe vient faire saillie dans un intervalle intercondylien formé entre les condyles (8, 9) et s'insère dans le siège formé par l'intervalle intercondylien de manière à bloquer toute rotation axiale du fémur par rapport au tibia et telle que lors de la sortie du second insert de son siège lors de la flexion du

30       genou, il s'instaure entre les parois de l'intervalle intercondylien et le second insert un jeu progressif jusqu'à l'angle de flexion ( $\alpha_0$ ) déterminé à l'avance, à partir duquel les déplacements en rotation axiale sont libres.

35       2. Endoprothèse suivant la revendication 1, caractérisée en ce que le second insert (12) tibial a une surface supérieure comportant une crête (19) et une surface (21) extérieure, et la forme des condyles (8, 9) du côté avant du genou sont telles, qu'en position étendue du genou, la crête (19) bloque en flexion, comme en rotation propre tout mouvement du fémur et

40       qu'au fur à mesure que le genou se plie, un jeu progressif apparaît entre les condyles et la crête (19) et la face (21) extérieure, pour permettre une possibilité limitée en rotation propre jusqu'à un angle de flexion déterminé à l'avance et une libération totale au delà de l'angle de flexion déterminé à l'avance.

45       3. Endoprothèse suivant la revendication 1 ou 2 dans laquelle le premier insert (11) est monté rotatif par rapport à la plaque tibiale et le second insert (12) est monté fixe par rapport à la plaque tibiale.

50

4. Endoprothèse suivant l'une des revendications 1 à 3, dans laquelle l'angle  $\alpha_0$  déterminé à l'avance est compris entre 20 et 40°, de préférence 30°.

55       5. Endoprothèse suivant l'une des revendications 2 à 4, caractérisée en ce que la crête (19) de l'insert (12) est constituée de trois tronçons (22, 23, 24) en forme d'arcs de cercle dont les

# **EP 1 018 322 A1**

convexités sont alternées, le tronçon de milieu (23) ayant sa convexité tournée vers le haut de manière à pouvoir pénétrer dans l'intervalle intercondylien, et la face (21) supérieure tournée vers l'insert (11) mobile a une forme incurvée pour former deux deuxième surfaces de glissement respectives pour les premières surfaces extérieures de glissement des condyles (8, 9).

6. Endoprothèse suivant l'une des revendications 1 à 5, dans laquelle l'organe de couplage est constitué d'un tourillon (27) et d'une tête (25) de couplage, le tourillon étant monté fixe en rotation ou rotatif dans la tige (5) tibiale, en traversant le premier insert (11) par une ouverture de l'insert, la tête (25) de couplage étant évidée pour recevoir un axe (28) de couplage fixé aux condyles et assurant la rotation en flexion du fémur par rapport au tibia.

**EP 1 018 322 A1**





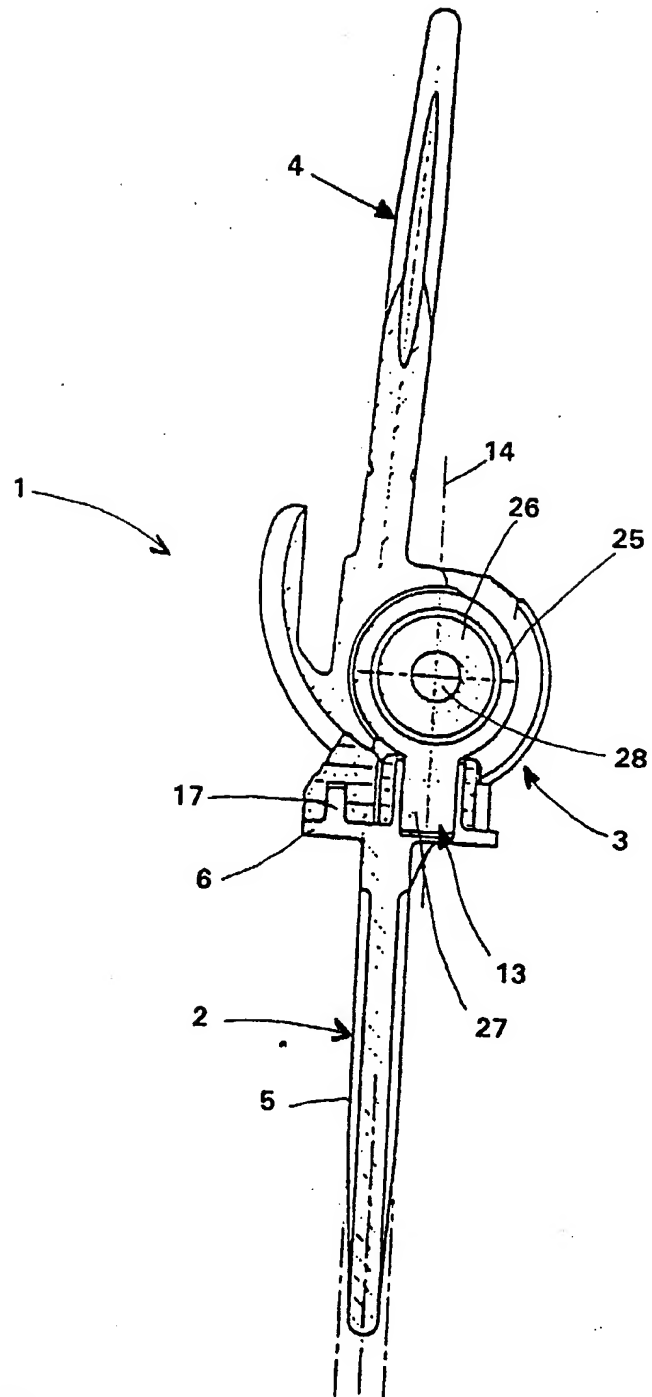


FIG. 1

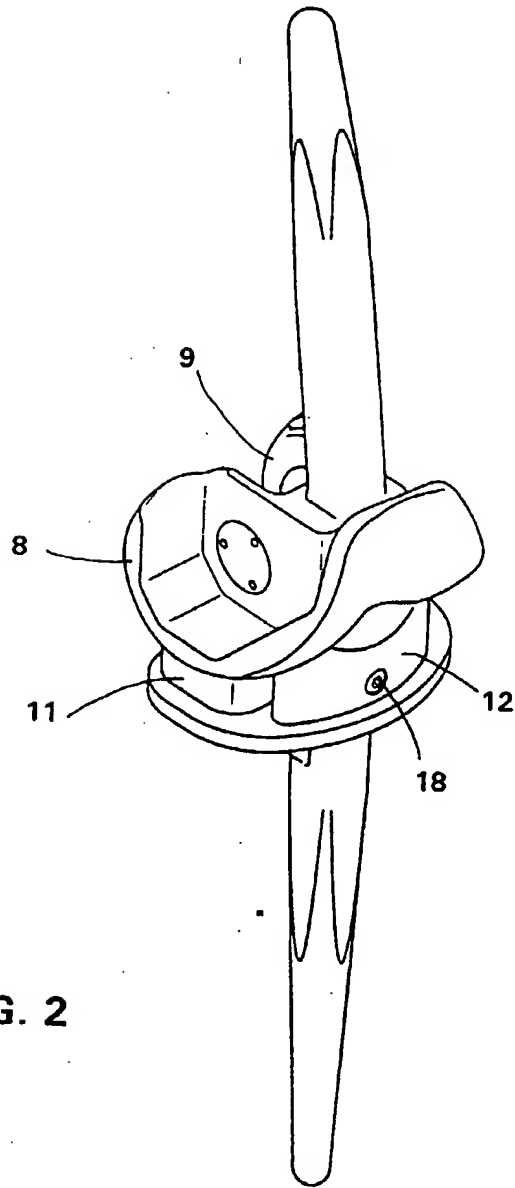


FIG. 2

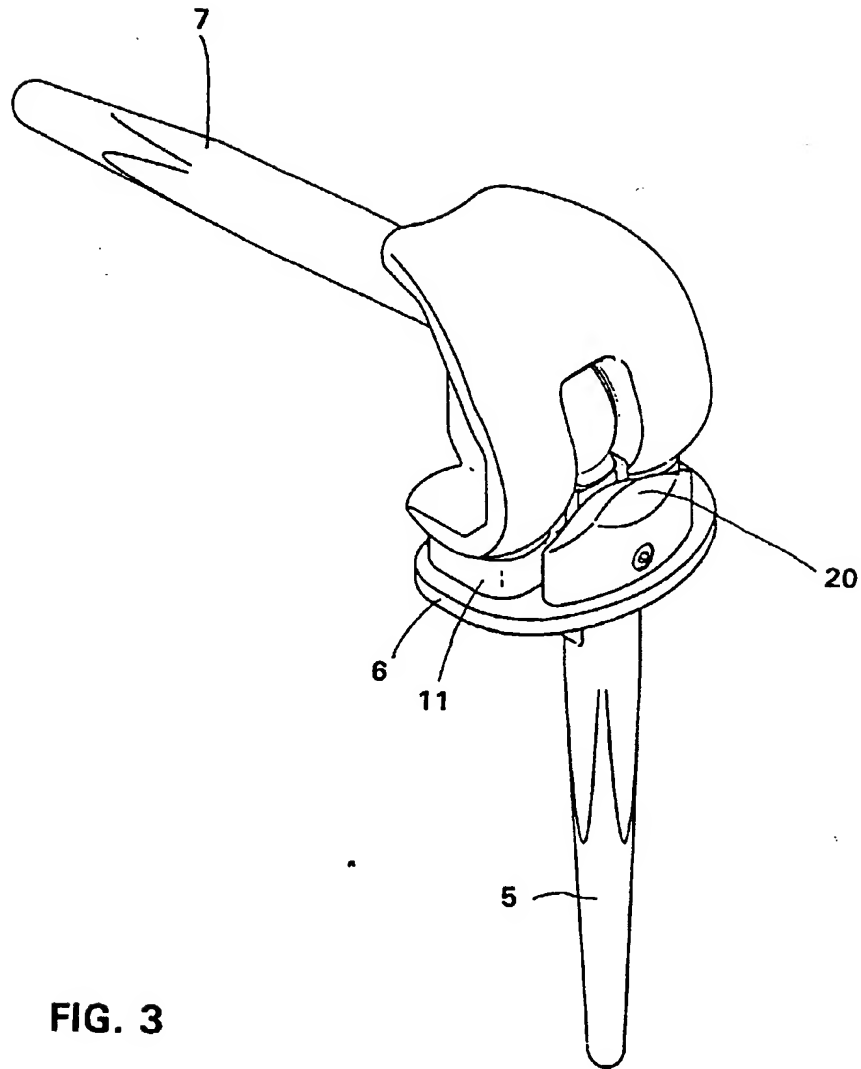


FIG. 3

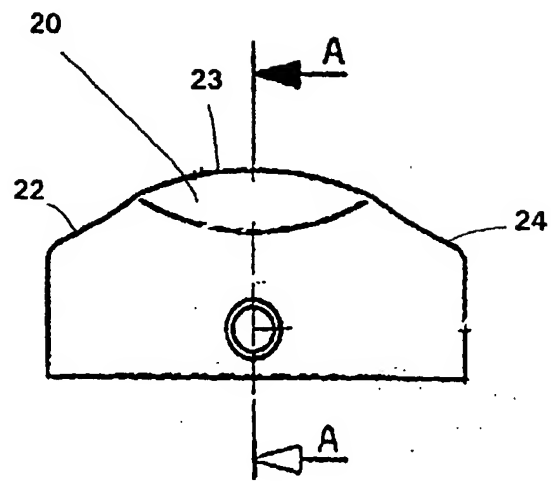


FIG. 4b

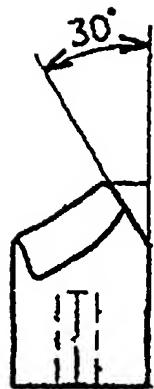


FIG. 4a

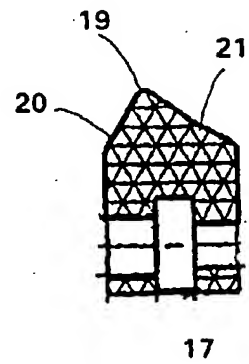


FIG. 4c

EP 1 018 322 A1

# EP 1 018 322 A1



Office européen  
des brevets

## RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande  
EP 99 40 3314

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.7)
X	DE 35 29 894 A (ORTHOPLANT ENDOPROTHETIK) 5 mars 1987 (1987-03-05) * colonne 5, ligne 23 - ligne 38; figures 1,2 *	1,2,6	A61F2/38
X	US 4 268 920 A (NIEDER ELMAR ET AL) 26 mai 1981 (1981-05-26) * colonne 6, ligne 14 - ligne 41; figures *	1,2	
X,P	FR 2 776 919 A (LE BEGUEC PIERRE) 8 octobre 1999 (1999-10-08) * revendications; figures *	1	
A	EP 0 724 868 A (SULZER MEDIZINALTECHNIK AG ;ALLO PRO AG (CH)) 7 août 1996 (1996-08-07) * colonne 9, ligne 10 - colonne 10, ligne 15; figures 5A-5E *	1,4	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.7)
			A61F
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 18 avr11 2000	Examinateur Villeneuve, J-M
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons &amp; : membre de la même famille, document correspondant</p>			

EPO FORM 1503 03/82 (P4/C02)

# EP 1 018 322 A1

## ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.

EP 99 40 3314

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.  
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du  
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

18-04-2000

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
DE 3529894 A	05-03-1987	AUCUN	
US 4268920 A	26-05-1981	DE 2744710 A CH 647405 A FR 2405064 A GB 2005545 A,B	19-04-1979 31-01-1985 04-05-1979 25-04-1979
FR 2776919 A	08-10-1999	DE 19915053 A	07-10-1999
EP 0724868 A	07-08-1996	AUCUN	

EPO FORM P0460

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82